


# 绍兴市胜达医药保健用品有限公司

## 成品检验报告

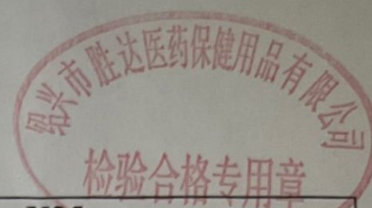

| 产品名称 | 弹性创可贴     | 规格型号                                        | 76mmX25mm          |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| 生产批号 | 20250213  | 生产数量                                        | 300 盒 (20 片 X20 盒) |
| 抽样日期 | 20250214  | 检验日期                                        | 20250214           |
| 检验依据 | 创可贴产品技术要求 |                                             |                    |
| 序号   | 标准项目      | 技术要求                                        | 结论                 |
| 1    | 外观        | 1.1 创可贴应厚薄、色泽均匀，表面清洁、平整，无污渍和破损等现象           | 合格                 |
|      |           | 1.2 基带与吸湿层应平整地附着于隔离层上，切割线应平整，无翻边、卷边和叠边等现象。  | 合格                 |
|      |           | 1.3 吸湿层应置于基带的中央位置，无破损及自然脱落等现象。              | 合格                 |
|      |           | 1.4 若在吸湿层上使用不粘层，则不粘层应完全覆盖在吸湿层上，无破损及自然脱落等现象。 | 合格                 |
|      |           | 1.5 隔离层应完全覆盖在创贴的基带上，无基带和吸湿层外露等现象。           | 合格                 |
| 2    | 尺寸        | 2.1 背贴(长度 X 宽度) (mm): 76X25 误差士 2。          | 合格                 |
|      |           | 2.2 敷垫(长度 X 宽度)(mm): 23X25 误差士 2。           | 合格                 |
| 3    | 吸水率       | 创可贴吸水层的吸水率应不小于 120%                         | 合格                 |
| 4    | 剥离强度      | 创可贴胶带的剥离强度应不低于 1.0N/cm                      | 合格                 |
| 5    | 持粘性       | 创可贴胶带的持粘性应不大于 2.5mm                         | 合格                 |
| 检验合格 |           | 合格                                          |                    |

检验员: 王军



审核员:

吴建利

